





## جدول راهنمای سیفتی باکسهای P.I.P.

۱۲	٧	۵	٣	٢	١/۵	٠/۵	٠/٣	٠/٠٨	/حجم* مدل/
<b>✓</b>	<b>✓</b>								Cc
		<b>/</b>	<b>✓</b>	<b>/</b>	<b>✓</b>	<b>/</b>			Cd
							1	<b>/</b>	Р

									· · · ·				
٣.	75/4	۲۵	77	۱۵	11/0	9/0	٨/۵	۵/۵	4/0	۴	٣/۵	7/0	حجم. دل/
					<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>✓</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	Ra
<b>/</b>		<b>/</b>	/	<b>/</b>									Rb
	<b>/</b>												XL




## سيفتى باكس جيبى 80cc

- جداسازی و امحاء ایمن انواع سوزن سرنگها ( بویژه سرنگهای انسولین)
  - کاربری آسان و ایمن
- تجهیزی ایده آل برای افراد مبتلا به دیابت در تمام شرایط کار، سفر و ...
  - قابل استفاده برای تمامی سرنگهای انسولین
  - دارای درب با قفل دو مرحلهای (موقت و دائم)

## نحوه استفاده:

- ۱- درب را به صورت کشویی باز نمایید.
- ۲- سوزن را با استفاده از شیارهای تعبیه شده بر روی دهانه، جدا نمایید.
  - ۳- درب سیفتی باکس را ببندید.
- توجه: پس از هر بار استفاده درب به صورت موقت بسته شود و پس از پر شدن سیفتی باکس، درب آن به صورت دائم بسته شود.

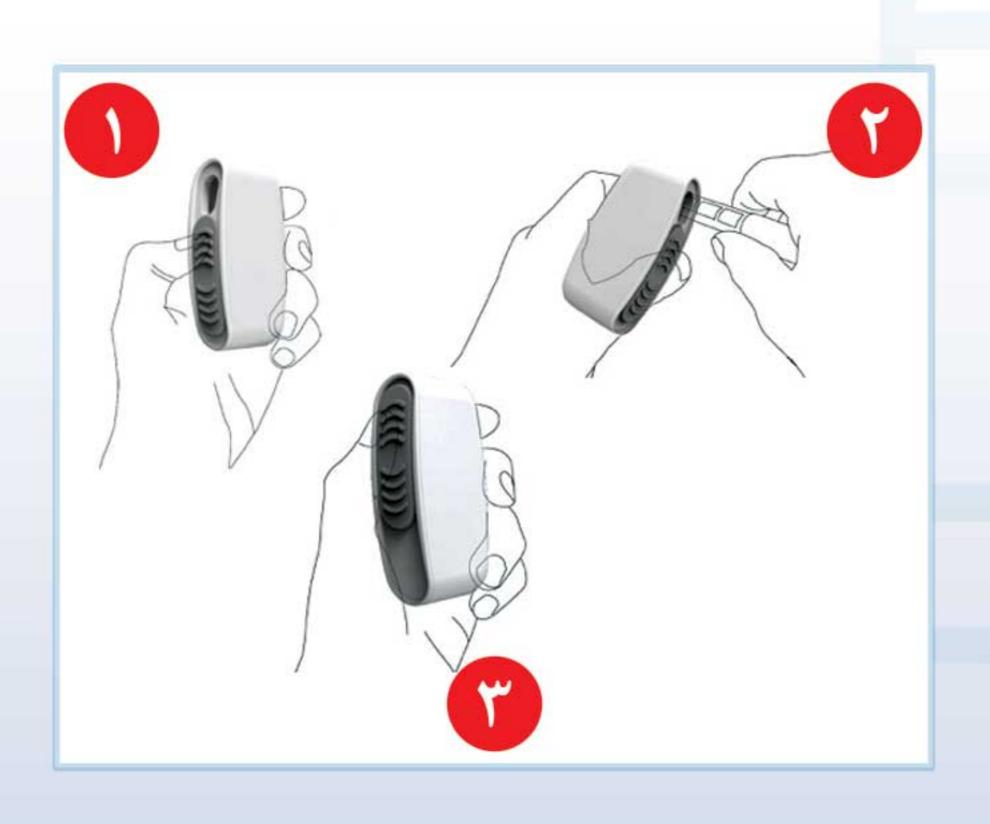



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول تلفىن: ٩-٢٢٩٥٩٢٨ فكىس: ٨٨٧٤٧١٥٩ و ٨٨٧٤٥٩٢٢ و کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳-۱۵۸۷۵







